



赤外線リフロープロファイル(鉛フリー)

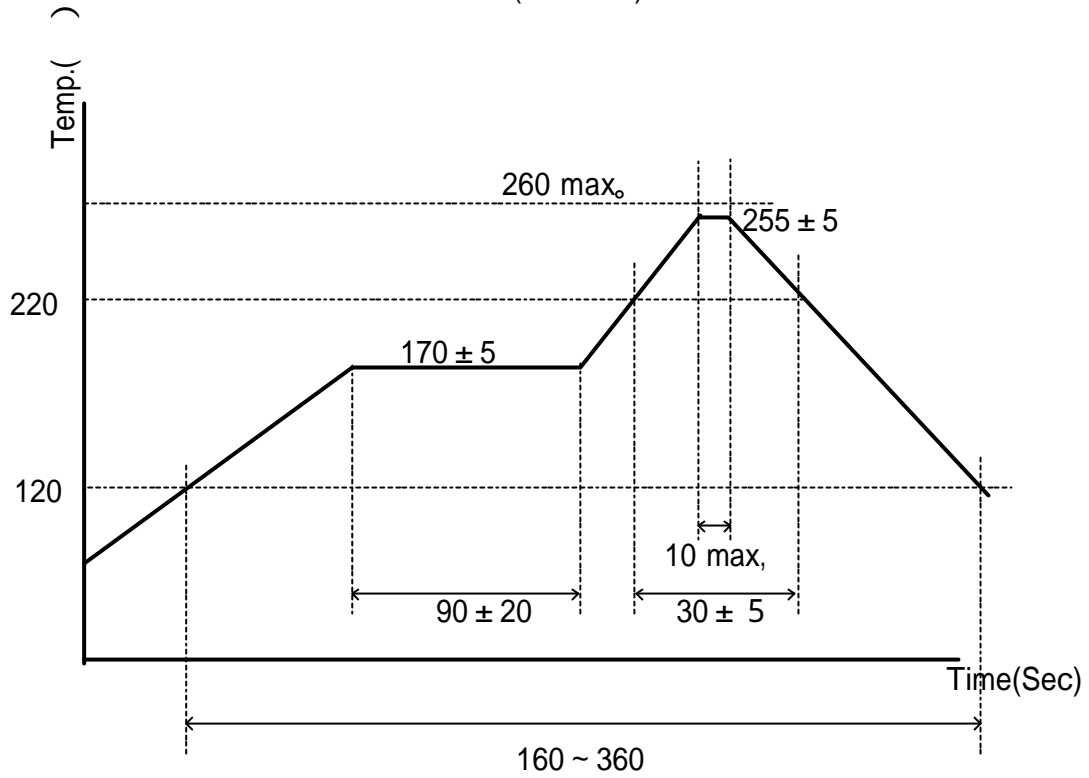

1. リフローは1回限りとしてください。(2度リフローを行わないようお願いします。)
2. ユーザーで両面リフローを行う場合に発振器を裏面にして(逆さ)リフローは行わないようお願い致します。

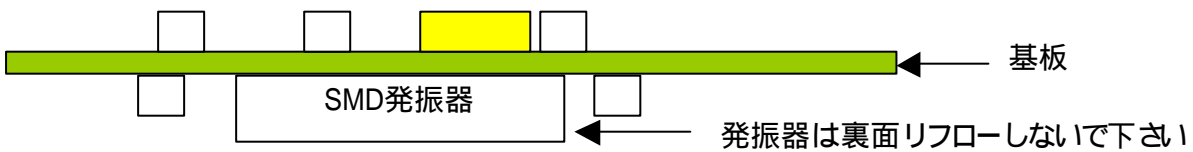

株式会社ナカ アンド カンパニー
2005年9月3日